

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 15 lutego 2018 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.02.2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

I.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 pozycja 7 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kołec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2 pozycji 7 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody.

II.

Zadanie 4

Pyt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycje 1-12 do oddzielnego pakietu ?

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 9-12 i stworzenie z nich niezależnego pakietu ?

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3 – Czy Zamawiający w pozycji 1-8 dopuści: kaniule dożylnie posiadające wgłębienie w igle, bez otworu, kaniula posiada przezroczystą komorę kontrolną z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem umożliwiającą szybką identyfikację wkłucia, wykonana z poliuretanu z 3 paskami dobrze kontrastującymi w RTG, koreczek portu bocznego domykany standardowo, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, jedynie dwa rozmiary minimalnie różnią się od wymaganych: 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min; 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 4 – Czy Zamawiający w pozycji 9-12 dopuści: kaniule dożylnie, bezpieczne posiadające 3 paski kontrastujące w RTG, filtr hydrofobowy, koreczek portu bocznego domykany standardowo,

wykonana z poliuretanu, kaniula posiada przezroczystą komorę kontrolną z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem umożliwiającą szybką identyfikację wkłucia, mechanizm zapobiegający zakłuciu i zachłapaniu podczas użytkowania, rozmiary: 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min; 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min; 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min; 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min; 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min?

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.

III.

1. dot. zapisów SIWZ rozdz. III pkt. 1.2.2.

Zamawiający wymaga aby etykiety (oryginalne) dostarczanych wyrobów były sporządzone w języku polskim.

Zgodnie z art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Ponieważ opakowania zastosowane przez producenta SARSTEDT AG&Co posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez wyroby oryginalnych etykiet w języku polskim jako dostosowanie do istniejących przepisów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Ad.1 Zgodnie z SIWZ.

2. dot. pakietu nr 5

Ponieważ strzykawki do gazometrii z filtrem pakowane są po 100 szt. w opakowaniu handlowym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zamawianych ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.

Ad.2 Zgodnie z SIWZ.

IV.

Pakiet 17- materiały do sterylizacji

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych (Poz. 1-9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Ad.1 Zamawiający wyłącza z Pakietu nr 17 pozycje od nr 1 do nr 9 włącznie i tworzy z tych pozycji oddzielny Pakiet numer 17a. Wypełnienie pozycji numery 1 do 9 włącznie będzie traktowane jako złożenia oferty na Pakiet 17a. Porównanie złożonych ofert w pakiecie 17 nastąpi po odjęciu kwot z pozycji 1 do 9 włącznie jeżeli zostaną wypełnione.

V.

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Ad.1. Patrz SIWZ rozdział VI punkt C, podpunkt a „W przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Tak złożone oświadczenie Zamawiający uzna za aktualne i nie będzie wzywał Wykonawcy do ponownego jego złożenia.”

Pakiet 25, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przewód odsysający o średnicy wewnętrznej 5,6mm?
Inne parametry tak jak w SIWZ.


Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza.

VI

Pytanie nr 1 – pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26, poz. 1 zestawu uniwersalnego z łatą chłonną z serwetą na stół Mayo, Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O., chłonność w strefie krytycznej – min. 900% w składzie :

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

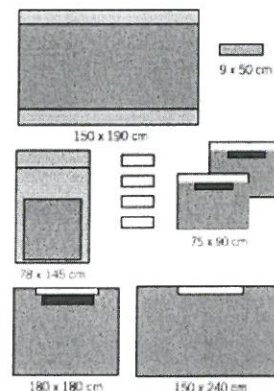


Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – pakiet 26, poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26, poz 2 zestawu do operacji ginekologicznych w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami

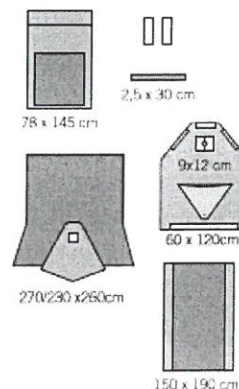


- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 – pakiet 26, poz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26, poz 2 zestawu do cięcia cesarskiego w składzie:

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torebką na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

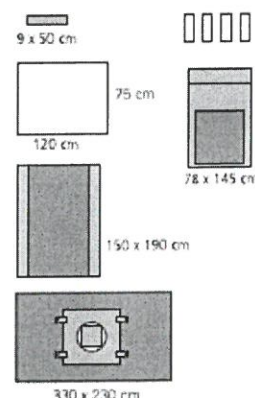

Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – pakiet 26, poz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26, poz 4, serwety o gramaturze min 60g/m²?

Ad.4 Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 – pakiet 26, poz 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26, poz 5, serwety o gramaturze min 60g/m² z otworem 6x8 cm?

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 – pakiet 26, poz 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26, poz 6 serwety na stolik MAYO, wykonanej z folii- PE piaskowanej 60 µm niebieskiej, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m².

Ad.6 Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 – pakiet 26, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26, poz 7: Ręcznik do rąk wykonany z celulozy wzmacnianych nitką nylonową, pakowane po jednej sztuce , wymiary 30,5 x 34cm.

Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – pakiet 26, poz 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26, poz 9, jednorazowego jałowego uniwersalnego fartucha operacyjnego, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m², posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m², przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok, 2

troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora.
Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H₂O Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 200kPa
Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 9 – pakiet 26, poz 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26, poz 9, jednorazowego jałowego uniwersalnego fartucha operacyjnego, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m², przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok, 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora.
Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H₂O Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 200kPa
Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – pakiet 26, poz 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26, poz 10 zestawu brzuszno-kroczonego w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczonego 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przyлеpnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

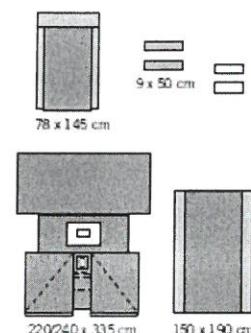

Ad.10 Zamawiający nie wyraża zgody.

VII.

Pakiet nr 28

1. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 i 2 Pakietu nr 28, parametry narzędzi zgodne z opisem.

Ad.1 Zamawiający wyłącza z Pakietu nr 28 pozycje 1 i pozycje nr 2 łącznie i tworzy z tych pozycji oddzielny Pakiet numer 28a. Wypełnienie pozycji numery 1 do 2 łącznie będzie traktowane jako złożenia oferty na Pakiet 28 a. Porównanie złożonych ofert w pakiecie 28 nastąpi po odjęciu kwot z pozycji 1 i 2 łącznie jeżeli zostaną wypełnione.

Pakiet nr 32

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 32 dopuści zaoferowanie worka o wymiarach 17 cm x 24 cm o pojemności 1100 ml, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 32 dopuści zaoferowanie worka o wymiarach 11 cm x 20 cm, z trzonem o średnicy 10 mm, o pojemności 435 ml, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza.

VIII.

Dotyczy Oświadczenia odnośnie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP- grupa kapitałowa- wymóg złożenia oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust.5 uPzp.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Ad.1. Patrz SIWZ rozdział VI punkt C, podpunkt a „W przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Tak złożone oświadczenie Zamawiający uzna za aktualne i nie będzie wzywał Wykonawcy do ponownego jego złożenia.”

Pakiet nr 14 poz.1,2,3,4

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach wycenę za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości? Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Ad.2 Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz.14

Prosimy o dopuszczenie ww pozycji papier do Lifepacka o rozmiarze 107x23 .

Ad.3 Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz.16

Prosimy o informacje czy Zamawiający oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego?

Ad.4 Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny, zamawiający dopuszcza papier oryginalny.

IX.

Pytania dot. asortymentu:

Pakiet 13

Poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków pakowanych w kartoniki?

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków o gramaturze min. 17g/m², o długości denka 30,5cm, szerokości denka w najszerszym punkcie 20cm i głębokości czepka w przodzie 22cm?

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków o gramaturze min. 17g/m² i długości 64cm?

Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych z włókniny typu SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu z bluzą i spodniami ze ściętym rękawkiem/nogawkami, bez podwinięcia i obszycia?

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 17

Poz. 1-9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej ilości firm złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Ad.6 Zamawiający wyłącza z Pakietu nr 17 pozycje od nr 1 do nr 9 włącznie i tworzy z tych pozycji oddzielny Pakiet numer 17a. Wypełnienie pozycji numery 1 do 9 włącznie będzie traktowane jako złożenia oferty na Pakiet 17a. Porównanie złożonych ofert w pakiecie 17 nastąpi po odjęciu kwot z pozycji 1 do 9 włącznie jeżeli zostaną wypełnione.

Poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o szerokości 380cm?

Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 26

Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej ilości firm złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z folii polipropylenowo-polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 56g/m² i chłonności na całej powierzchni min. 570%?

Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókniny wiskozowej, folii polipropylenowo-polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 73g/m² na całej powierzchni, odporności na przenikanie cieczy min. 191cm H₂O i chłonności na całej powierzchni min. 824%?

Ad.10 Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dolną samoprzylepną w rozm. 170x180cm i ręcznikami w rozm. 20x40cm?

Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z 2 ręcznikami?



Ad.12 Zamawiający nie wyraża zgody.

X.

1. Dotyczy Pakiet nr 17, pozycja nr 1-9: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment stanowią rękawy papierowo-foliowe. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Ad.1 Zamawiający wyłącza z Pakietu nr 17 pozycje od nr 1 do nr 9 włącznie i tworzy z tych pozycji oddzielny Pakiet numer 17a. Wypełnienie pozycji numery 1 do 9 włącznie będzie traktowane jako złożenia oferty na Pakiet 17a. Porównanie złożonych ofert w pakiecie 17 nastąpi po odjęciu kwot z pozycji 1 do 9 włącznie jeżeli zostaną wypełnione

2. Dotyczy Pakiet nr 17, pozycja nr 1-9: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające 5-warstwową folię. Produkt charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza.

3. 2. Dotyczy Pakiet nr 17, pozycja nr 17 i 22 : Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment stanowi element systemu dokumentacji. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza.

XI.

Dot. Pakiet nr 1 pozycja 14 - 15

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 14 – 15 z pakietu nr 1? Umożliwi to złożenie ofert większej ilości Wykonawców.

Ad.1 Zamawiający nie wydziela, zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakiet nr 1 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy 21 G (0,8mm), głębokość nakłucia 2,4mm w kolorze zielonym?

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakiet nr 1 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy 21 G (0,8mm), głębokość nakłucia 1,8mm w kolorze niebieskim?

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Pakiet nr 1 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy 25 G (0,5mm), głębokość nakłucia 1,5mm w kolorze fioletowym?

Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza

XII.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pakiet 17

Pozycje 1-9

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Ad. 1.A) Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Ad. 1. B) Zamawiający wymaga.**Pozycja 10**

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barrierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Ad. 2 A). Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu?

Ad. 2. B) Zamawiający wymaga.**Pozycja 13**

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

Ad.3 Zamawiający wymaga.**Pozycja 15**

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Ad.4a. Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

Ad.4b. Zamawiający wymaga.**Pozycja 16**

Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim?

Ad.5. Zamawiający wymaga.**XIII.**

pakiet nr 18

poz 83. Czy zamawiający dopuszcza zamiennie opakowania zawierające 50szt w ilości opakowań 40op, równoważne 100szt x20op?

Ad.1. Zamawiający dopuszcza.

poz 99. Producent wycofał z rynku opakowania 80g. Czy zamawiający akceptuje opakowanie 30g? W jakiej ilości?

Ad.2. Zamawiający akceptuje opakowanie 30g w ilości 5 opakowań.

poz 105. Proszę o sprecyzowanie czy zamawiający pyta o kompozyt Bright Light czy Neo Bright? Nazwa Neo Bright Light nie występuje.

Ad.3. Zgodnie z SIWZ.

XIV.

Pakiet nr 3, poz.1

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma na myśli kaniulę dotętniczą z ostrzem otwartym czy zabezpieczonym przed zakłuciem?

Ad.1. Zamawiający wymaga kaniuli z ostrzem otwartym.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniuli do dostępu naczyniowego z zatraskiem typu Flow Switch z cewnikiem wykonanym z PTFE, pakowanej w TYVEK z systemem mocowania z okienkiem z folii paro przepuszczalnej, z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 2 piankowymi podkładkami pod skrzydełka kaniuli i z dodatkowym piankowym paskiem do prowadzenia linii?

Ad.2. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 19, poz.1

Czy Zamawiający oczekuje błon stomatologicznych tego samego producenta co odczynników chemicznych celem zachowania najwyższej jakości obróbki fotochemicznej błon i tym samym poprawności diagnostyki?

Ad.3. Zamawiający oczekuje błon stomatologicznych tego samego producenta co odczynniki chemiczne.

Pakiet nr 32, poz.1

Prosimy o doprecyzowanie, czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający wymaga kaniuli bez zintegrowanego portu iniekcyjnego, tak jak obecnie stosowana?

Ad.4. Zamawiający informuje o oczywistej pomyłce w tej pozycji. Zamawiający wymaga kaniuli bez zintegrowanego portu.

XV.

Pakiet nr 1 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,10.

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,20

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 23

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wpisane w program 20 ml Luer lock pompy BD/20.

Ad.4. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 25-27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta pompy, z wykazem strzykawek dopuszczonych do stosowania przez producenta pompy.

Ad.5. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 6 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy.

Ad.6. Zamawiający nie dopuszcza.

XVI.

Pakiet 31, poz. 1

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 31, poz. 1 na: automatycznie otwierany woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 220 ml, średnica trokaru 10 mm, otwierany samoczynnie, przezroczysty. Wykonany z materiału odpornego na bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia, ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, z efektem pamięci automatycznie utrzymujący woreczek otwarty, przewodnik zaopatrzony w uchwyt do wyzwiania woreczka, sterylne?

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę.

XVII.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. W razie wystąpienia zwłoki przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia brutto.**

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

XVIII.

Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1,2

Czy Zamawiający oczekuje, żeby wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

Ad.1. Zamawiający wymaga żeby wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania .

Dotyczy SIWZ

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone

stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Ad.2. Zamawiający potwierdza.

Dotyczy zawarcia umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy § 12 ust. 5 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § na zapis:

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części) może nastąpić jednostronnie w każdej chwili:

- w przypadku powtarzającego się kolejnego, 2-krotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką (...)

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody.

XIX.

Pakiet 4, pozycje 1 - 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule bez dodatkowego otwory w igle?

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycje 1 - 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule z korkiem portu bocznego domykany ręcznie?

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 61ml/min?

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 128ml/min?

Ad.4. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 196ml/min, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad.5. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycje 8 - 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi zamiast filtra hydrofobowego?

Ad.6. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycje 8 - 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule z korkiem portu bocznego domykany ręcznie?

Ad.7. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 9, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze nr 15?

Ad.8. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 9, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze nr 27?

Ad.9. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje kieliszków do leków wielorazowego użytku, sklasyfikowanych jako wyrób medyczny - stawka VAT 8% ?

Ad.10. Zamawiający dopuszcza, Zamawiający nie wymaga.

Pakiet 15, pozycje 19 - 20

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wydaliny 30ml?

Ad.11. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści sterylną sondę Sengstakena w rozmiarze CH 20 ?

Ad.12. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka w rozmiarze CH 24 lub CH 30?

Ad.13. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 45

Czy Zamawiający oczekuje aby napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi były fabrycznie umieszczone przez producenta na opakowaniu (nie doklejone) ?

Ad.14. Zamawiający dopuszcza, Zamawiający nie wymaga.

Pakiet 15, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu z workiem o pojemności 2000ml?

Ad.15. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 60

Czy Zamawiający ma na myśli fartuchy o długości min. 180cm ?

Ad.16. Zamawiający dopuszcza, Zamawiający nie wymaga.

Pakiet 15, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki schodkowe o średnicach zewnętrznych 7,5mm / 15,5mm (min. / max.) ?

Ad.17. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki schodkowe o średnicach zewnętrznych 4,5mm / 7,7mm (min. / max.) ?

Ad.18. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 76

Czy Zamawiający dopuści maski 2-panelowe?

Ad.19. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 78

Czy Zamawiający dopuści skalpel w rozmiarze 10 lub 15?

Ad.20. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad.21. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2 o średnicy około 53cm?

Ad.22. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad.23. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 3,4

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, o średnicy około 47cm?

Ad.24. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w kartonik?

Ad.25. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim?

Ad.26. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Ad.27. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm +/- 1cm. Długość gumki 14,5



cm +/- 1cm. Szyty techniką overlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Ad.28. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²

Ad.29. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści bluzę z rękawem prostym ciętym (nie obszytym) oraz spodnie z nogawkami ciętymi (nie obszytymi)?

Ad.30. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne dostępne tylko w rozmiarach S-XXL?

Ad.31. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści czepek typu harmonijka wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 10g/m²?

Ad.32. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta wykonaną z jasnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²?

Ad.33. Zamawiający nie dopuszcza.

XX.

Pytanie 1 dotyczące pakietu nr 36 oraz zapisów umowy paragraf 4 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z dostaw na „cito” w przypadku zdania 36?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 dotyczące pakietu nr 36 oraz zapisów umowy paragraf 4 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego termin do 3 dni roboczych?

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin dostaw na „CITO” do trzech dni roboczych w przypadku pakietu nr 36.

Pytanie 3 dotyczące pakietu nr 36 oraz zapisów umowy paragraf 4 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin dostaw na „CITO” do trzech dni roboczych w przypadku pakietu nr 36

Pytanie 4 dotyczące zapisów umowy paragraf 8: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że atesty o których mowa w paragrafie 8 umowy mogą być dostarczone mailem, pocztą na wezwanie Zamawiającego?

Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa sprzętu i dostarczanie atestu do każdej dostawy będzie bardzo uciążliwe logistyczne dla Wykonawcy

Ad.4. Zamawiający potwierdza, że atesty mogą być dostarczone mailem, pocztą na wezwanie Zamawiającego.

XXI.

Pytanie

Pakiet 13, poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety włókninowej jałowej w rozmiarze 80cm x 90cm

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 13, poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety wykonanej z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, który stanowi lepszą barierowość serwety.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza.

XXII.

Pytanie nr 1.

Dotyczy: Załącznik nr 7 – Pakiet nr 19 – Błony dentrystyczne i odczynniki chemiczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do obróbki mechanicznej w opakowaniach 4x0,5l, gdzie w opakowaniu znajduje się utrwalacz 4x0,5l i wywołувacz 4x0,5l? Prosimy o przychylenie się do naszej prośby i dopuszczenie do postępowania odczynników o wskazanych pojemnościach z przeliczeniem na odpowiednią ilość opakowań

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

XXIII.

Załącznik nr 7,

Pakiet 11, pozycja 33.

Pytanie 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 33 do oddzielnego pakietu co umożliwiłoby udział w postępowaniu większej ilości dostawców.

Ad.1. Zgonie z SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści łyżki jednorazowe w rozmiarze 0,00 typu Miller a pozostałe typu Macintosh?

Ad.2. Zamawiający dopuszcza.

XXIV.

Pakiet 15, pozycja 71- Czy zamawiający oczekuje, aby worki wyposażone były we wkład żelujący, pochłaniający płyny, zapach?

Ad.1. Zamawiający dopuszcza, Zamawiający nie wymaga.

XXV.

Pakiet nr 20 – Elektrody do diatermii ERBE VIO 200S oraz wyposażenie kompatybilne do diatermii ERBE ICC – 300 i VIO 300 D

Poz. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 4, 6, 10 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 5, 13

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 100 mm

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 7, 14, 17

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5 metrów

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 200 mm

Ad.4. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3 metry

Ad.5. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 100 mm i długości ostrza 20 mm

Ad.6. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 100 mm o średnicy igły 0,8 mm długość igły 12 mm

Ad.7. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 16

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 100 mm i wymiarach noża 3,3 x 25mm

Ad.8. Zamawiający nie dopuszcza.

XXVI.

pakiet 18.

pkt 22 Wiertła na kątnicę diamentowe kulki, nr 29- Wiertła w wybranym rozmiarze nie występują na kątnicę. Możliwe rozmiary to 27 lub 33. Jaki rozmiar wybiera zamawiający?

Ad.1. Zamawiający wybiera rozmiar 33.

pkt 61 Paski metalowe ściernie szer 5mm. - Szerokość 5mm nie występuje, dostępne szerokości 4mm lub 6mm. Jaką szerokość zamawiający akceptuje?

Ad.2. Zamawiający akceptuje szerokość 6 mm.

XXVII.

pakiet nr 18, poz 97 - czy zamawiający akceptuje podkład na bazie wodorotlenku wapnia 12g bazy +12g katalizator?

Ad.1. Zamawiający nie akceptuje.

XXVIII.

Pytanie 1 dotyczy rozdziału III, pkt 2 SIWZ

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie częściowe według pozycji w pakietach?

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie i zostaje wyznaczony na dzień 20 lutego 2018 roku na godzinę 11⁰⁰.


p.o. Dyrektor
SPZZOZ Sierpcu
Rafał Wiśniewski